




# S30 压电偏摆镜 用户手册

版本 : V1 日期 : 2023. 03



本手册中的内容适用于以下产品：

S30.T1K S30.T2S/K



# 声明

## 感谢您选用芯明天产品！

本用户手册适用于 S30 系列压电偏摆镜产品，为了您顺利、正确的使用本产品，请在使用前仔细阅读本手册，安装及使用过程请按手册中的有关说明进行操作。不当操作可能会使操作者受到伤害或者导致产品的损坏，所以要求整个安装、操作过程均应由具有一定基础、对产品原理有一定了解的专业人员来完成，或者在专业人员的指导下完成。

如未经允许自行对本产品进行拆卸、改造，我公司将不对由此所产生的任何后果承担责任。

对于更改产品型号等虚假销售我司产品的均属违法行为，请广大用户提高警惕，一经发现或上当要积极举报或与我司联系，共同打击违法，防止上当受骗和经济损失。芯明天一定会追究违法主体与关联方的法律责任。

伴随着技术的不断发展与创新，我公司会根据需要及时将有关最新信息加入到手册中，如有需要请联系我们，或到我们的网站上进行下载，由于我们不能及时的通知到您给您带来的不便请谅解。

# 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1. 关于本手册 .....    | 2  |
| 1.1 编写目的和内容 ..... | 2  |
| 1.2 符号及其含义 .....  | 2  |
| 1.3 预期读者 .....    | 2  |
| 1.4 手册丢失补发 .....  | 2  |
| 2. 安全指南 .....     | 3  |
| 3. 产品概述 .....     | 4  |
| 3.1 产品简介 .....    | 4  |
| 3.2 工作原理 .....    | 4  |
| 3.3 产品特性 .....    | 6  |
| 3.4 运动方向 .....    | 6  |
| 4. 工作环境 .....     | 7  |
| 5. 安装及操作 .....    | 8  |
| 5.1 安装与注意事项 ..... | 8  |
| 5.2 加载 .....      | 10 |
| 5.3 操作 .....      | 11 |
| 6. 运输及检验 .....    | 11 |
| 6.1 运输 .....      | 11 |
| 6.2 开箱检验 .....    | 12 |
| 7. 维护与处理 .....    | 12 |
| 7.1 问题处理 .....    | 12 |
| 7.2 日常保养维护 .....  | 13 |
| 7.3 废旧产品处理 .....  | 13 |
| 7.4 驱动线和传感线 ..... | 14 |
| 8. 客户服务 .....     | 14 |
| 9. 联系我们 .....     | 15 |



## 1. 关于本手册



### 1.1 编写目的和内容

本手册主要是为了您能顺利、正确的使用本公司产品。

手册包含了 S30 系列偏摆镜产品的所有必要信息。

介绍了安装和使用过程中的注意事项。

### 1.2 符号及其含义



危险：不当的操作可能会对操作者造成伤害。



注意：不当的操作可能会对设备造成损害。

- 各项之间无顺序要求
  
- 1. 按顺序操作
- 2.

### 1.3 预期读者

本手册默认用户具备压电偏摆镜和控制器的相关知识，并且对其安装和使用有一定的基础。

### 1.4 手册丢失补发

如本手册不慎丢失，请联系我们客服部门，我公司会给您免费发送最新版本的用户手册。



## 2. 安全指南

S30 压电偏摆镜采用最先进的技术和安全标准设计而成。为了您的自身安全及产品的正确使用，使用时请注意以下几点：



温度改变和压力都会给压电驱动器充电，与控制器断开连接的一段时间压电驱动器也会保持带电状态，所以操作者在使用时要注意：

- ▷ 不要擅自拆卸 S30 压电偏摆镜；
- ▷ 在安装以前给 S30 进行放电，这个可以通过和控制器连接实现；
- ▷ 在操作过程中不要拔出控制器；
- ▷ 使用前首先检查本产品的连接线是否完好，产品及控制器是否进行了有效的接地保护，操作过程中应严格规范操作，上电后不要用手触碰产品（最高可达 150V 电压），以防发生危险。



为了防止不当操作对产品造成损坏，使用时应注意以下几点：

- ▷ S30 压电偏摆镜尽量在无尘、无油、无润滑剂的环境中使用；
- ▷ 由于产品采用柔性结构设计，建议负载不要超过本产品的承载能力，装载时注意扭力不要过大，不要撬或扭转负载面，以免损伤结构；
- ▷ 长期使用建议使用电压范围为 0~120V；
- ▷ 请勿对产品进行拆解，以免造成产品损坏；
- ▷ 避免拉伸和弯曲电缆接口，防止对电缆造成损坏；
- ▷ 使用我公司提供的专用电缆连接 S30 压电偏摆镜和控制器；
- ▷ 不能随便使用电缆延长线，如需要更长电缆请联系我公司客服。

## 3. 产品概述

### 3.1 产品简介

S30 压电偏摆镜有以下几个优点：

► 高可靠性陶瓷：

S30 系列偏摆镜使用高可靠性陶瓷驱动器驱动，驱动器采用全绝缘结构，因此其性能和使用寿命远远优于传统驱动器，绝缘层可以有效防止压电陶瓷受潮而失效。因此在极端的环境下也能保证压电陶瓷的稳定性，与传统驱动机构相比，没有转动部件和摩擦，因此陶瓷驱动器具有无反弹、免维护、无磨损等特点。

► 柔性铰链结构：

S30 系列偏摆镜采用柔性铰链机构，具有无摩擦、定位精度高等优点，柔性铰链是一种不受静态和动态摩擦影响的元件，基于固体（例如钢）的弹性变形并且没有滚动和滑动部分，柔性单元具有很高的刚度和承载能力，铰链导向无需维护并且无磨损，不需要润滑油。

► 应变计传感器：

应变计传感器通过本身膨胀来检测位置信息，它们被固定在传动部分的适当位置，测量出移动部分的位移，这种类型的位置测量是通过接触和间接测量出来的。因此移动平台位移是通过测量杠杆、导向铰链或者压电陶瓷堆测量出来的。

S30 压电偏摆镜整体采用柔性铰链结构、具有无机械摩擦、响应速度快、重复定位精度高等优点。本产品还可以根据需求来进行定制，具有极高的灵活性，操作简便，满足不同应用场合。

### 3.2 工作原理

压电控制原理框图如下所示：

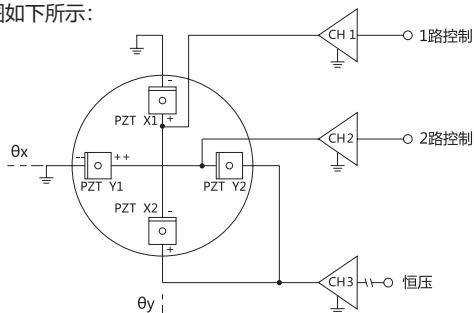


图 1 S30 控制原理框图

偏摆镜（两轴）是基于四个压电陶瓷结构设计而成，每轴采用两个压电陶瓷，以推拉模式行程偏摆运动，采用桥式连接电路控制，四个机构以 90 度平分放置，可以消除温度对压电陶瓷的影响，在大范围温度变化下保持良好的角度稳定性。

### 偏摆镜偏转角度计算




图 2 偏摆镜示意图

绕 X 轴偏转角度为：

$$\theta_x = (L_{PZT1} - L_{PZT2}) / a$$

其中：

$L_{PZT1}$  - PZT1 位移；

$L_{PZT2}$  - PZT2 位移；

a - 两个陶瓷之间的距离；

同理，绕 Y 轴的偏转角度为：

$$\theta_y = (L_{PZT3} - L_{PZT4}) / b$$

偏摆镜动态特性：

S30 的使用频率大小取决于产品的共振频率，为了估算加载镜片以后的共振频率（运动面和镜片），镜片的转动惯量必须考虑在内，镜片的转动惯量计算如下：

圆柱形截面镜片的转动惯量

$$I_m = m \left[ \frac{3R^2 + H^2}{12} + \left( \frac{H}{2} + T \right)^2 \right]$$

矩形截面镜片的转动惯量

$$I_m = m \left[ \frac{L^2 + H^2}{12} + \left( \frac{H}{2} + T \right)^2 \right]$$

其中：

$M$  - 镜片质量

$I_m$  - 镜片的转动惯量

$L$  - 垂直于旋转轴的镜片长度

$H$  - 镜片厚度

$T$  - 旋转轴到平台表面的距离

$R$  - 镜片半径

利用空载共振频率和镜片的转动惯量可以计算整体的共振频率，计算公式如下所示：

$$f' = \frac{f^0}{\sqrt{1 + I_m / I_0}}$$

其中：

$f'$  - 整体的共振频率

$I^0$  - 空载运动面转动惯量

$f^0$  - 空载共振频率

$I_m$  - 镜片转动惯量

## 3.3 产品特性

- ▷ 高精度传感器，定位精度高
- ▷ 具有亚微弧度分辨率
- ▷ 响应速度快

## 3.4 运动方向

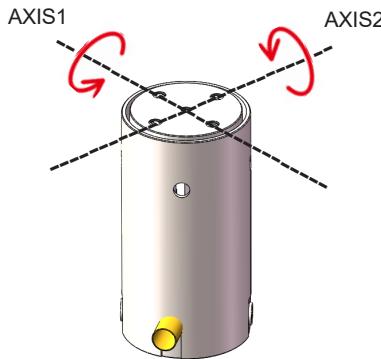


图 3 S30 压电偏摆镜运动方向

S30 连线标识与运动方向对应表如下：

| 型号      | 运动方向       | 类别  | 连接线标识 |
|---------|------------|-----|-------|
| S30.T1K | $\theta_x$ | 驱动线 | CH1   |
|         |            | 传感线 | 1     |
| S30.T2K | $\theta_y$ | 驱动线 | CH2   |
|         |            | 传感线 | 2     |
| S30.T2S | 恒压         | 驱动线 | CH3   |

表 1 连线标识与运动方向

## 4. 工作环境

工作温度： -20~80°C

无尘、清洁、无腐蚀性物质存在的环境

相对湿度： <60%

长期工作建议使用电压在 0~120V 可以极大地延长产品的使用寿命。



## 5. 安装及操作



### 5.1 安装与注意事项

安装前首先要进行安全检查，如连接线有无破损、断线，驱动电源有无接地保护等。

S30 安装示意图如下所示：



图 4 S30 安装示意图

1、粘贴镜片前先清洁镜片粘贴平面，镜片粘贴后等待一段时间后再进行固定安装，如图所示；



2、选用 M2 螺钉固定安装，也可通过转接方式进行偏摆镜的安装，安装前先清洁安装支架，也可以联系我们按图所示选择合适的转接方式进行安装。

3、将产品固定在安装平面上或者通过相关工装固定在安装平面上，注意相关转镜产品如要进行其他放置（如侧置、斜置等）请来电咨询我们；



图 5 转接方式

4、连接接地保护，如图所示；

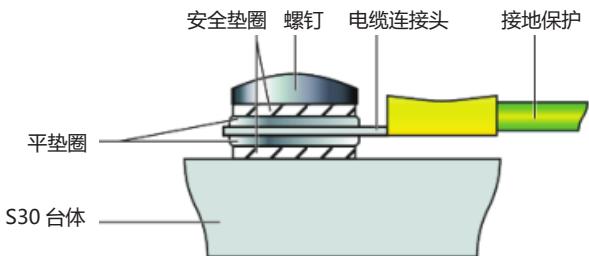


图 6 接地保护示意图

5、将 S30 偏摆镜的连接线与控制器连接起来；

LEMO 连接头接线方式如下图所示：

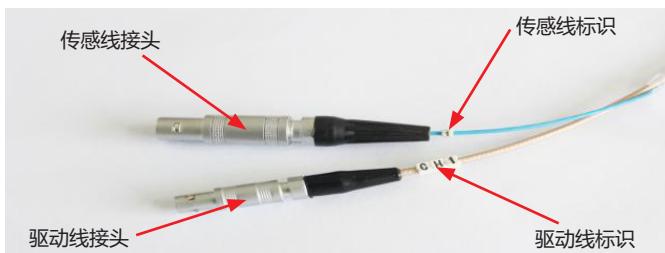


图 7 连接头示意图

安装注意事项：

- ▷ 不要磕碰产品运动部分，防止柔性铰链变形影响运动精度，甚至损坏产品；
- ▷ 柔性铰链缝隙中不要滴入镜片粘结剂，也不要有关其他物体阻碍运动，以免影响精度或损坏设备；
- ▷ 请选择合适的螺钉进行固定连接，防止螺钉松动影响使用效果。

整个安装、操作过程中注意规范操作，学员请在专业人士的指导下进行相关操作。

## 5.2 加载

安装镜片负载时确保质量小于 S30 偏摆镜最大承载，尽量将镜片安装在运动面中心位置。  
负载的正确放置方式如下图所示：

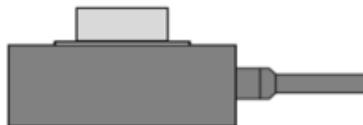


图 8 负载加在工作台的台面中心

对于产品的保护我们不建议负载过高，如必须采用较高的负载请适当减小负载重心位置，错误放置方式如下图所示：

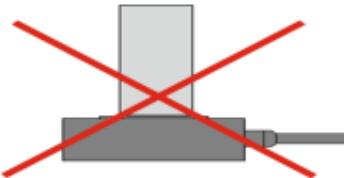


图 9 尽量不要让负载重心远远超过活动平台

禁止将负载加载在运动台的一侧，这会对产品造成严重的破坏，如下图所示：

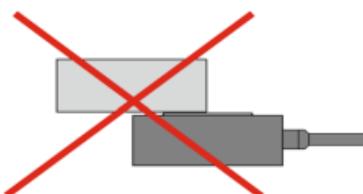


图 10 禁止加载较长负载且加在活动台的一侧

注意事项：

- ▷ 安装负载时缓慢拧紧负载，扭矩不要太大，以免损伤机构；
- ▷ 避免拉伸电缆和弯曲电缆；
- ▷ 使用我公司提供的专用电缆连接 S30 压电偏摆镜和控制器；
- ▷ 不要擅自延长电缆，如需更长电缆请联系客服。

## 5.3 操作

电源启动之前请再次确认以下信息：

- ▶ S30 偏摆镜已经接地保护；
- ▶ 使用环境符合 S30 产品工作环境要求；
- ▶ 固定螺钉必须拧紧；

以上信息确定以后进行控制器相关操作：

- 1、操作前请仔细阅读用户所选用的控制器用户手册，然后再启动控制器；
- 2、先对控制器置零设置；
- 3、检查无异常现象后，根据需求输入电压值（键盘或模拟控制）；
- 4、可在压电陶瓷额定电压范围内（0~120V，最大不要超过 150V）正常工作；
- 5、使用完毕后请进行电压清零操作；

请在操作中放轻脚步，不要磕碰产品，以免影响产品使用甚至损坏产品。

产品自身的分辨率是没有限制的，分辨率取决于产品控制器的性能，为了更好的达到台体的运动精度，推荐使用我公司的配套产品控制器。控制器的具体操作方法请参照控制器使用手册，确保能够正确操作以后再进行相关操作。

注意：

- ▶ 操作过程中不要移除接地保护，如果需要暂时移除，再次启动前请重新连接好接地保护；
- ▶ 驱动电压不要超过 S30 偏摆镜允许的最大电压；
- ▶ 使用过程中如果出现异常响动或者振荡，则立即关闭电源检查参数设置；



## 6. 运输及检验

### 6.1 运输

本产品采用纸箱包装，运输是在产品包装条件下进行的，本产品在正常情况下可用各种运输工具进行运输，运输过程中应避免雨雪直接淋袭、避免接触腐蚀性物质，避免发生强烈的碰撞，尽量避免挤压、不规则摆放等不当行为。

## 6.2 开箱检验

检查内容：

- ▷ 打开包装前请您先仔细检查外包装有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等状况；
- ▷ 请以供货合同和装箱单为依据，逐件清查核对包装内容是否完备；
- ▷ 产品表面是否有明显的破损；
- ▷ 产品标识是否清晰、完整；
- ▷ 连接器是否松动、连接线有无断裂破损等；

如有上述情形发生，请做详细记录，并拍照留据，同时请立即联系我们进行处理。

注意事项：

- ▷ 打开包装时请注意轻拿轻放，以免发生磕碰造成台体永久性损坏；
- ▷ 请不要使用重型工具或采用粗暴方式进行开启；
- ▷ 所有的包装材料请不要丢弃，以备返修退运时所需；
- ▷ 运输过程中使用原包装盒，防止包装不当造成产品损坏；

## 7. 维护与处理

### 7.1 问题处理

常见问题如下表所示：

| 问题描述         | 可能的原因        | 解决办法         |
|--------------|--------------|--------------|
| 偏转角度变小       | 连接线连接不对或接触不良 | 检查连接线连接情况    |
|              | 负载过大         | 按产品最大负载承载    |
|              | 传感器零点漂移      | 对传感器进行校核     |
| 精度变小         | 安装平面不平       | 将台体安装在较平的平面上 |
|              | 连接松动         | 紧固连接         |
|              | 接线不对         | 检查接线是否正确     |
| 启动时振动或者定位不精确 | 控制参数不对       | 立即停止，检查参数设置  |
|              | 发生共振         | 使驱动频率小于共振频率  |

表 2 常见问题及解决办法

用户在使用过程中如出现问题不能自己解决,请详细记录故障情况与我公司联系,由专业技术  
人员来协助解决。

操作不当引发的问题不在质保范围内;

未经允许私自拆解产品造成的一切问题,我公司概不负责。

## 7.2 日常保养维护

如较长时间不使用产品,请包装好后贮存在无尘、通风良好、清洁、无腐蚀性物质存在的室内  
环境下。

在日常保养维护中请不要松动产品结构上的螺栓,以免影响产品的运动精度。

日常的清洁:

请将产品与控制器进行连接分离后再对产品表面进行清洁工作。

清洁时先用毛巾蘸取少量清洁剂轻轻擦拭产品表面,然后再用酒精清洗,请不要用超声波进行  
清洗。

## 7.3 废旧产品处理

废旧产品处理时要根据国家及当地的规章制度进行处理,为了履行我公司作为产品制造商的责  
任,会对市场上所有旧的设备进行环保处理,如果您有设备无法处理时可以邮寄到我公司。

地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 I2 栋

电话: 0451-86268790



## 7.4 驱动线和传感线

电缆接头形式有三种可选择，分别是雷莫连接器、D-sub15 三排插针公头连接器、DB13W3 连接器，其引脚定义如下：

- ▷ 驱动线和传感线为雷莫接头，定义如下：

驱动线采用单芯雷莫连接器，型号为 LEMO ERA.00.250.CTL 如下图所示：



图 11 单芯雷莫

传感线接口采用四芯雷莫，型号为 LEMO ERA.0S.304.CLL，如下图所示：




图 12 四芯雷莫



## 8. 客户服务



如果您有关于目前使用的产品需要咨询的问题，请告知我们以下信息：

- ▷ 产品的型号及相关编号；
- ▷ 本产品配套的控制器型号；
- ▷ 本产品配套的软件驱动版本；
- ▷ 安装配套软件的电脑操作系统。



## 9. 联系我们

**哈尔滨芯明天科技有限公司**

总 机: 0451-86268790 / 17051647888 (微信同号) 传 真: 0451-86267847  
网 址: [www.coremorrow.com](http://www.coremorrow.com) 邮 箱: [info@coremorrow.com](mailto:info@coremorrow.com)  
地 址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 I2 栋

**售后服务:**

邮 箱: [info@coremorrow.com](mailto:info@coremorrow.com)

**官方微信:**